

FG29 HyperMed Pump

QTY: 1 EA

Syringe pump

FG29

REF 4007430259158

LOT 00000000008

SN 0000000000



2017-10-24



USED BY:

2018-05-12

#1

#2 UDI

(01) 4 0074302 59158 8

(10) 00000000008

(17) 991231

(11) 171024

(21) 0000000000



0°C

20°C

UPPER LIMIT OF
TEMPERATURE

STERILE R

MD

exclusively for clinical investigation



Warning: The wrong placement of this device in the human body can result in hard attack!

Warnung: Die falsche Platzierung im menschlichen Körper kann zu Herzinfarkten führen!

Attention: Un mauvais placement dans le corps humain peut entraîner des crises cardiaques !

YOUR
LOGO
HERE



OPAL Associates Holding AG
Motorenstrasse 116116
8332 Wetzikon
Switzerland

EC REP

OPAL Associates GmbH
Am Vögelisberg 5
78479 Reichenau
Deutschland




<https://ifu.opal-holding.com/7610012000001>



UDI_LABEL_ISO20417 V 10

Differenzansicht

Zeitpunkt Erzeugung: 26.07.2021 14:24 Uhr

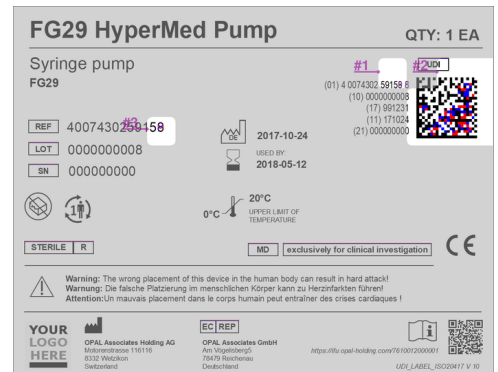

94% Übereinstimmung

3% Dokument 1 dunkler/schwarz


3% Dokument 2 dunkler/schwarz

Die Dokumente enthalten Grau- oder Farbanteile.

Dokument 1

0000000183_IMAGE_00001.pdf


Größe: 101 mm x 78 mm

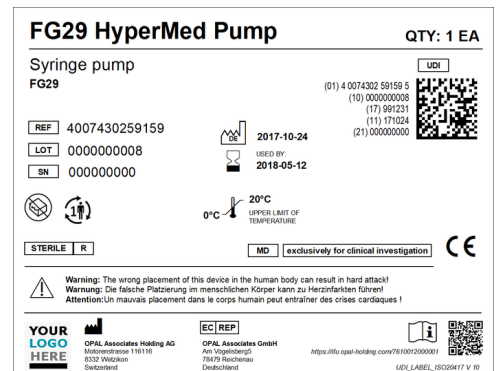

Dokument 2

0000000182_IMAGE_00001.pdf

Größe: 101 mm x 78 mm

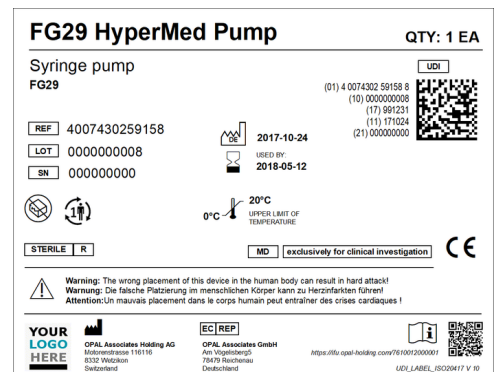

Anleitung

